
Mode d'emploi pour le patient utilisateur de Menopur® 600 IU /1200 IU

Avant de prendre Menopur, vérifier que tous les éléments nécessaires sont disponibles :

1. Flacon de Menopur (600 UI bouchon orange / 1200 UI bouchon bleu)
2. Seringue(s) de mélange pré-remplie(s) (1 seringue dans le conditionnement 600 UI / 2 seringues dans le conditionnement 1200 UI)
3. Aiguille de mélange
4. Tampons désinfectants
5. Seringues jetables pour injection (9 seringues dans le conditionnement 600 UI / 18 seringues dans le conditionnement 1200 UI)

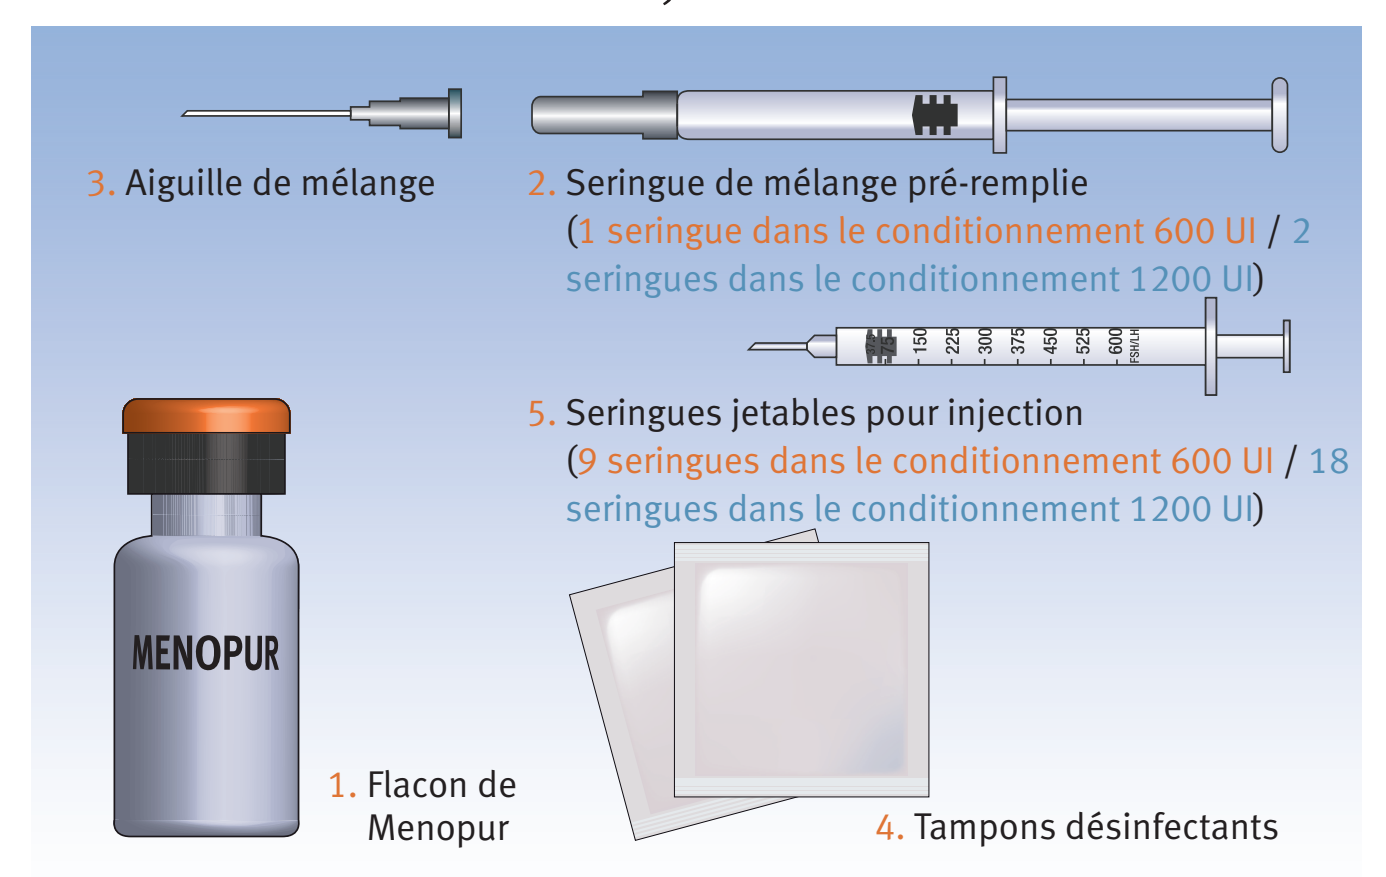


Remarque : le flacon de Menopur contient suffisamment de produit pour un traitement de plusieurs jours.


Avant mélange, Menopur doit être conservé au réfrigérateur.

Préparation


1. Enlever le bouchon du flacon de Menopur.

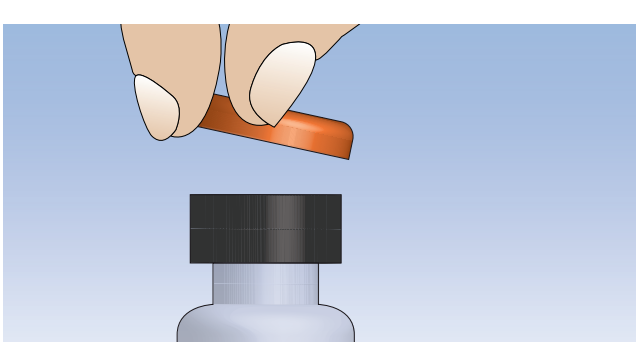


2. Enlever l'embout caoutchouc de la seringue de mélange.

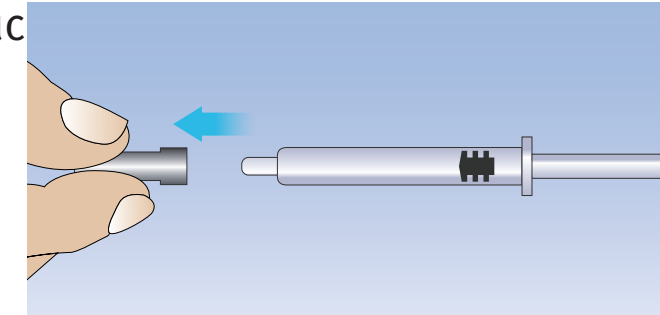


3. Enlever le capuchon noir de la seringue de mélange en le faisant tourner.

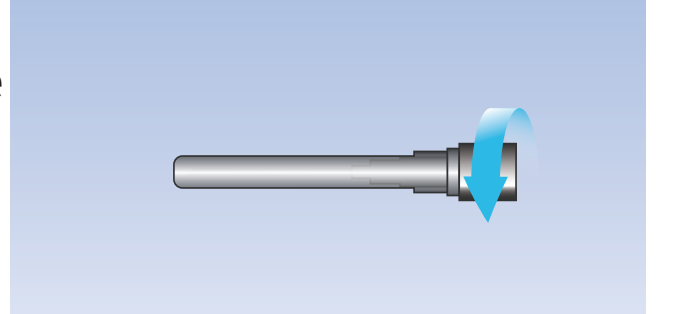

4. Fixer l'aiguille de mélange sur la seringue de mélange.

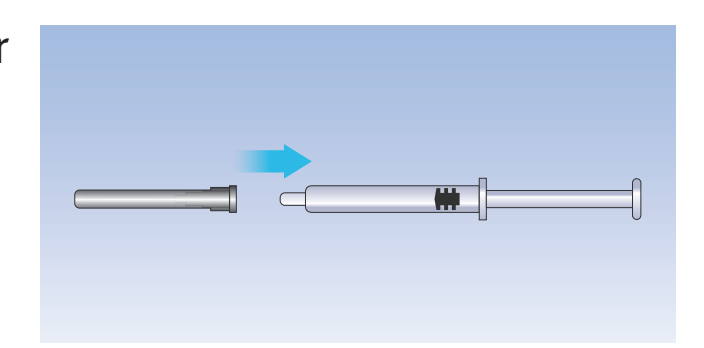


5. Enlever le capuchon de la seringue de mélange.

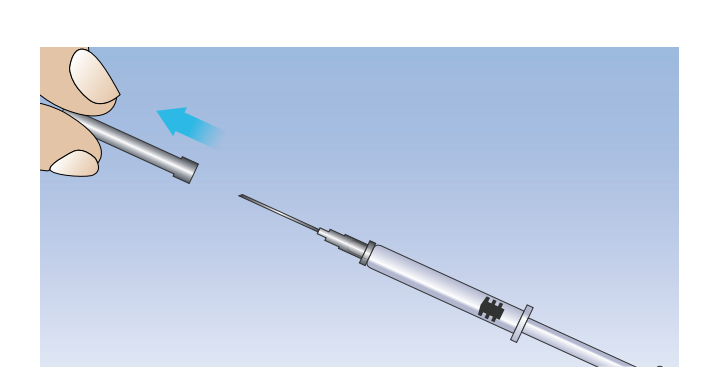


Mélange

1. Enfoncer l'aiguille de la seringue de mélange au centre de la membrane caoutchouc du flacon de Menopur et transférer doucement le liquide dans le flacon en poussant le piston.

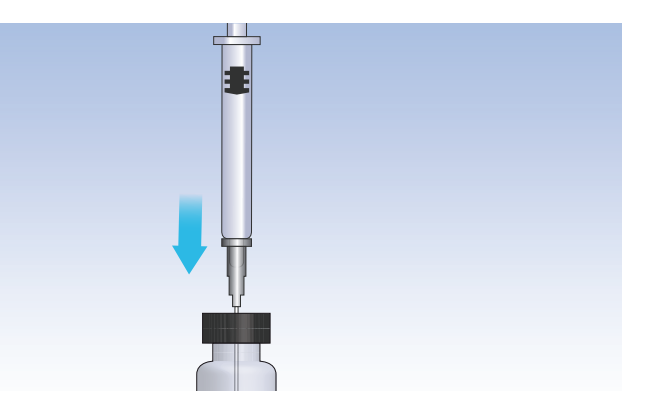

REMARQUE :
Pour une prescription de Menopur 600 UI, passer à l'étape 2.
Pour une prescription de Menopur 1200 UI, suivre les instructions ci-dessous.

Veiller à ce que l'extrémité de l'aiguille soit au-dessus du niveau de liquide dans le flacon de Menopur. Puis enlever la première seringue de mélange de l'aiguille en la faisant tourner. Laisser l'aiguille dans le flacon de Menopur 1200 IU.

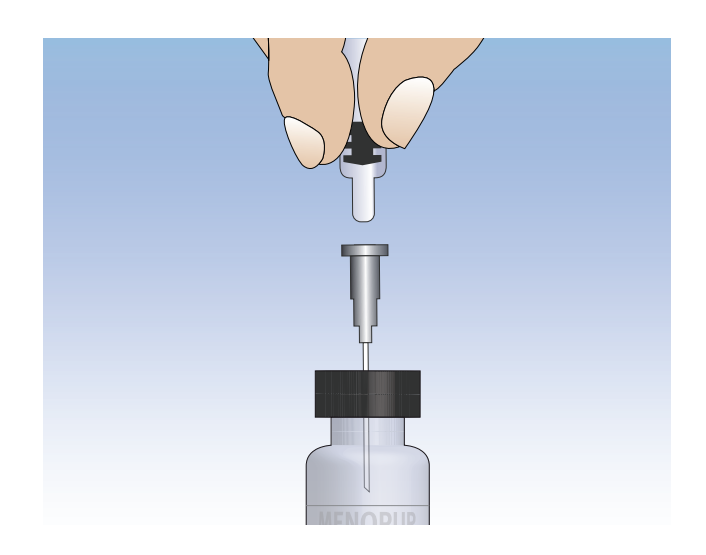

Prendre la deuxième seringue de mélange livrée dans la boîte. Renouveler l'étape 2 de la partie "Préparation" avec cette nouvelle seringue. Puis fixer la seringue à l'aiguille de mélange déjà en place dans le flacon et transférer délicatement le liquide dans le flacon.

2. Retirer alors la seringue de mélange et son aiguille du flacon de Menopur.


3. Faire tournoyer délicatement le contenu du flacon de Menopur pour dissoudre la poudre. Ne pas le secouer.




4. Le produit est à présent prêt à être utilisé et peut être conservé jusqu'à 28 jours à température ambiante (≤ 25°C) .

Injection

1. Prendre une seringue jetable pour injection et retirer le capuchon de l'aiguille. Poser le flacon de Menopur sur une surface plane et stable. Enfoncer l'aiguille au centre de la membrane caoutchouc du flacon de Menopur. Pousser le piston jusqu'au bout de la seringue.

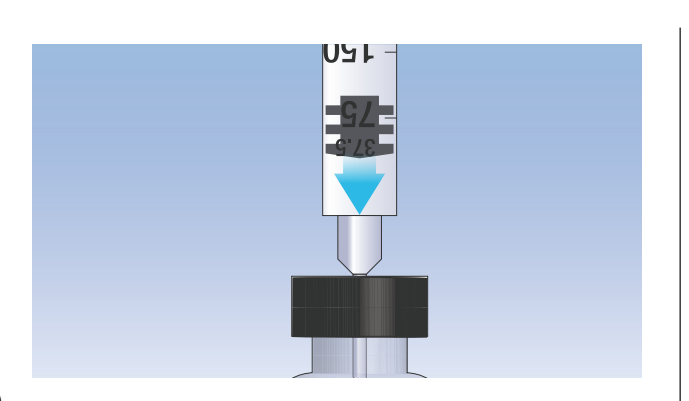


2. Retourner le flacon de Menopur et la seringue comme illustré sur le schéma et aspirer la dose de Menopur souhaitée en utilisant les graduations de la seringue.

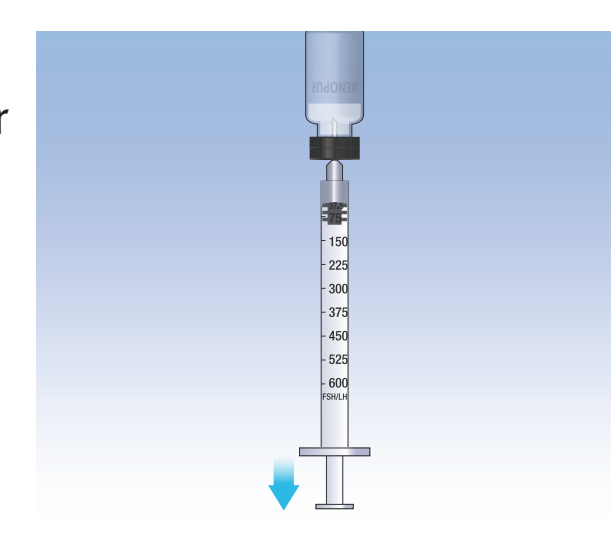

REMARQUE :
Le flacon de Menopur contient suffisamment de produit pour un traitement de plusieurs jours. Ne prélever que la dose exacte prescrite par le médecin.

3. Désinfecter la peau et injecter le produit selon les instructions du médecin ou de l'infirmière.

   D'une main, maintenir la peau sur le côté gauche ou droit. Planter perpendiculairement l'aiguille dans la peau (à 90°). Pousser doucement le piston jusqu'en bout de course. Lorsque la seringue est vide, retirer l'aiguille.

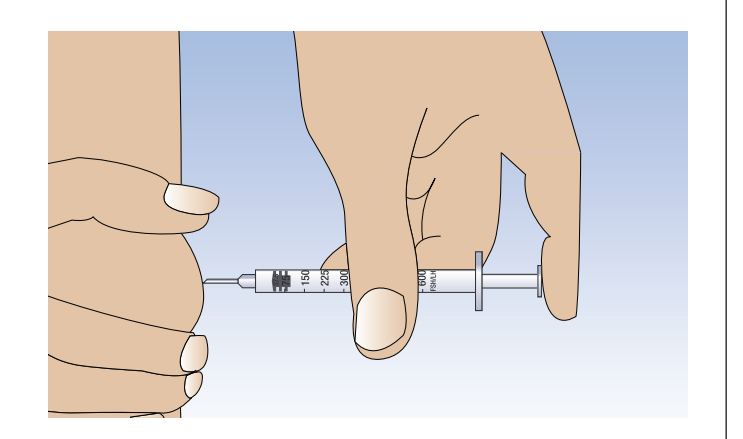

4. Changer de point d'injection comme indiqué par le médecin ou l'infirmière.

5. Jeter les seringues usagées dans un emballage à jeter (une brique de lait vide, par exemple).

6. Le produit restant dans le flacon de Menopur peut être conservé jusqu'à 28 jours à température ambiante (≤ 25°C) .

IMPORTANT
Avant mélange :
Menopur doit être conservé au réfrigérateur. Il peut toutefois être conservé à température ambiante (≤ 25°C) pendant 48 heures maximum, pendant le transport par exemple.

Après mélange :
Menopur peut être conservé jusqu'à 28 jours à température ambiante (≤ 25°C).

MENOPUR® 600 IU et 1200 IU - (Gonadotrophine ménopausique humaine, HMG) poudre et solvant pour solution pour injection
Indication : Anovulation incluant le syndrome ovarien polykystique (PCOS) chez les femmes non réceptives aux traitements à base de citrate de clomifène. Hyperstimulation ovarienne contrôlée pour provoquer le développement de follicules multiples pour les Techniques de procréation assistée (ART) incluant la fertilisation in vitro / le transfert d'embryon (FIV / ET), le "transfert de gamètes intratubulaire" (GIFT) et l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI). Dosage : Menopur est destiné à être administré par voie sous cutanée (SC) ou intramusculaire (IM) après reconstitution avec le solvant accompagnant le flacon. REMARQUE : Avant utilisation, Menopur 1200 IU doit être reconstitué avec deux seringues pré-remplies de solvant. La solution reconstituée peut être administrée par injections répétées et peut être utilisée pendant 28 jours. Code ATC : G03GA02. Conditionnements disponibles : Menopur 600 IU : 1 flacon, 1 seringue pré-remplie et 9 seringues jetables. Menopur 1200 IU : 1 flacon, 2 seringues pré-remplies et 18 seringues jetables. Rx, système de pharmacovigilance. Détenteur de l'autorisation de mise sur le marché (MAH) : Ferring Läkemedel AB, Malmö. Pour obtenir l'intégralité des caractéristiques du produit (SPC 3/12/2010) et connaître les tarifs, rendez-vous sur www.FASS.se.

Ferring Läkemedel AB, Box 4041, 203 11 Malmö, Suède
Tél. : +46 (0)40 691 69 00, Fax : +46 (0)40 691 69 95,
info@ferring.se, www.ferring.se

MEDICINE ON THE BODY'S OWN TERMS

